

Kullanımdan Önce ve Yeniden İşleme



2023 -06 -21
Pub. No.: K352-80142-500 (tr)

Daha fazla bilgi için QR kodunu okutun. ▶




* Tri Auto ZX2+'yi kullanmadan önce eşlik eden Kullanım Kılavuzu belgesini muhakkak okuyun.
* Yeniden İşleme yaparken daima uygun eldivenleri giyin.

Kullanımdan Önce

Bileşen Montajı


Adım 1

Ters Açılı Başlığı Bağlama

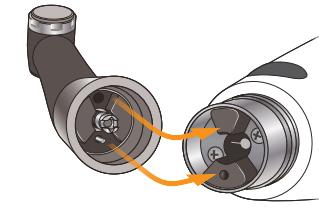


Adım 2

HP Koruyucu Manşonu Takma

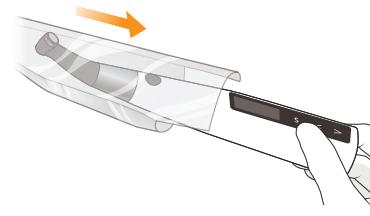

Adım 3


Prob Kablosunu Bağlama



DİKKAT
Dudak klipsinin (kanca) beyaz prob konnektörüne bağlandığından emin olun.

Adım 4

Eğeyi Takma

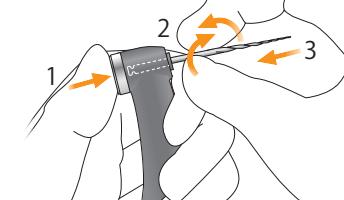

İşlev Kontrolü


Adım 1

Apeks Konum Bulma İşlevi

Güçü açın. Dudak klipsine (kanca) eže ve eže tutucunun ucundaki klips ile dokunun ve LCD ekranındaki ölçer üzerindeki tüm gösterge çubuklarının yanındından emin olun.



Tüm gösterge çubukları yanmazsa hemen cihazı kullanmayı durdurup onarım için uzmanlardan yardım alın.




Adım 2

Motorun Dönmesi

"m2" (OGP2 modu) ögesini seçin. Ana şaltere basın ve motorun düzgün çalıştığından emin olun.

! Motor düzgün dönmüyorsa veya abnormal gürültüler ya da titreşimler varsa cihazı kullanmayı hemen bırakın ve yerel satıcınızla veya J. MORITA OFFICE ile iletişime geçin.

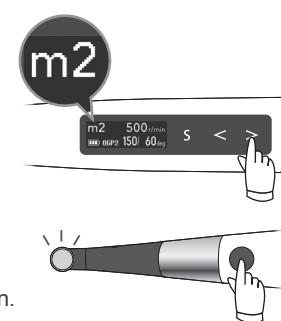


Güçü Açma/Kapatma

Açık



Kapalı



Kalibrasyon

(Satın aldıktan sonra ilk kullanımdan önce, ters açılı başlığı değiştirdikten sonra, düzensiz olarak veya rasgele OTR eylemi tetiklenirse vb.)

Ters açılı başlığı bağlayın. Cihaz kapalıken Sol-Ayar düğmesini (<) basılı tutun ve ardından Ana şaltere basın.




Kalibrasyonu başlatmak için Sağ-Ayar düğmesine (>) basın. Kalibrasyondan sonra cihaz otomatik olarak Bekleme ekranına döner.

Test Cihazı ile Kontrol (haftada bir)

Güçü açın. Test cihazını bağlayın. Ölçer okumasını kontrol edin.

• Ölçer, 1 numaralı çubugun iki çubuğu arasında yanarsa: Normal



• Ölçer, 1 numaralı çubuktan iki çubuga kadar daha fazla veya az yanarsa: Hemen cihazı kullanmayı durdurup onarım için uzmanlardan yardım alın.



Ekran Ayarları


Kullanıcının tercihine bağlı olarak aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir.

☞ Eşlik eden Kullanım Kılavuzu, "Diğer Anguldurva İşlevleri" bölümüne bakın.

Hakim El



EMR Ekranı Yönü



Yeniden işleme – her kullanımından sonra

Kullanımdan Sonra



Sterilizasyon

Sterile Edilecek Parçalar

- a. Eğe Tutucu
- b. Dudak Klipsi
- c. Uzun Eğe Tutucu
- d. Ters Açılı Başlık
- e. Anguldurva Tutucusu*
- f. Harici Eğe Elektrod (kapaklı)*

Adım 1 Tedavi öncesi



Adım 2 Temizlik ve Dezenfeksiyon

Yıkayıcı Dezenfektörler için Çalıştırma Koşulları

Ünitenin Adı	Miele G7881
Mod	Vario TD (temizleme süresi: 5 dakika)
Deterjan (konsantrasyon)	neodisher MediClean (%0,3 ila %0,5)
Durulama (konsantrasyon)	neodisher MediKlar (%0,03 ila %0,05)

Adım 3 Yağlama

(yalnızca ters açılı başlık için)

Ters açılı başlığı LS OIL ile yağlayın. Ters açılı başlıkta görünen fazla yağı silin.



Adım 4 Paketleme



Adım 5 Sterilizasyon

Öneri:

Ülke: ABD

Sterilizatör tipi	Sıcaklık	Süre (dakika)	Sterilizasyondan sonra kurutma süresi (dakika)
Yer çekimi	+132 °C	15	15
	+121 °C	30	

Ülke: ABD dışında


Dinamik Hava Giderme	+134 °C	3	10
	5		
Yer çekimi	+134 °C	min. 6	10
	+121 °C	min. 60	

Dezenfeksiyon

Dezenfekte Edilecek Parçalar

- g. Motor Anguldurva
- h. Prob Kablosu
- i. Pil Şarj Cihazı
- j. Kılavuz Çubuğu
- k. Test Cihazı

Adım 1 Tedavi öncesi



Adım 2 Temizlik ve Dezenfeksiyon

J. MORITA MFG. CORP.
Onaylı Dezenfektanlar

Dezenfektan	Ülke
Etanol (70 vol% ila 80 vol%)	ABD
Opti-Cide3 (mendil)	
FD366 sensitive (mendil)	ABD dışında

